


577

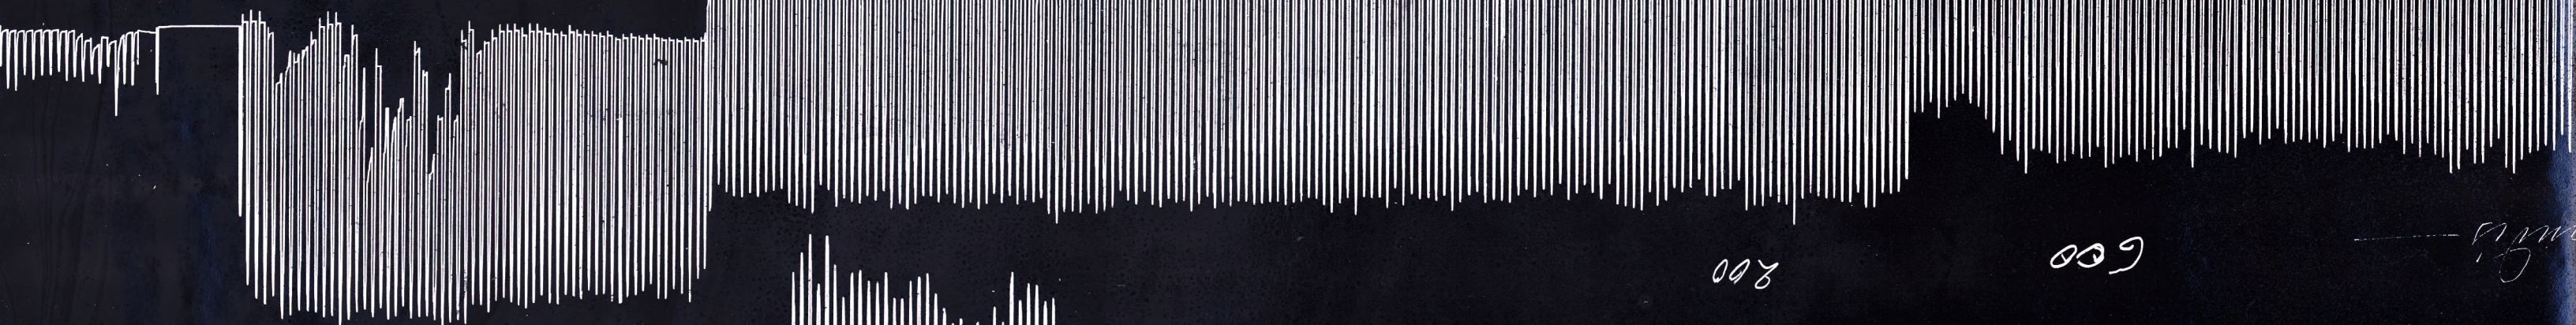

008

009

sim

di nuovo

Stimolo  
per l'urto  
I = 2  
Stimolo

Quarta irregolarità  
in aduce dove che  
dell'organismo e non  
del apparecchio  
perché subito dopo  
in grande manca



12 12.5